

直定規 アイビーム形ストレートエッジ

取扱説明書

「正しくお使いいただくために、必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。
またお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管して下さい。」



安全上のご注意

※ご使用の前に、この **取扱説明書** をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様への危険を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を **危険** **警告** **注意** の3つの区分にしています。


安全に正しくお使いいただくために	
この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。 その表示と意味は、次のようになっています。 ● 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。 ● お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。 ● 全て安全に関する内容ですから、必ずお守りください。	
 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。
 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
図記号の例	 △ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)
	 ○ 記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	 ● 記号は、行為を強制する内容を知らせるものです。 図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

直定規 アイビーム形ストレートエッジ 取扱説明書

1. 製品の特長

- ・加工面の検査や基準ガイドとして使用できます。
- ・歪みの少ない I 形構造を採用しています。
- ・精度保証範囲は、両端から 20mm を除いた呼び寸法と同一の長さです。
- ・1500mm 以上の製品には、持ち運びしやすいように取手用の長穴を設けています。

2. 姿 図

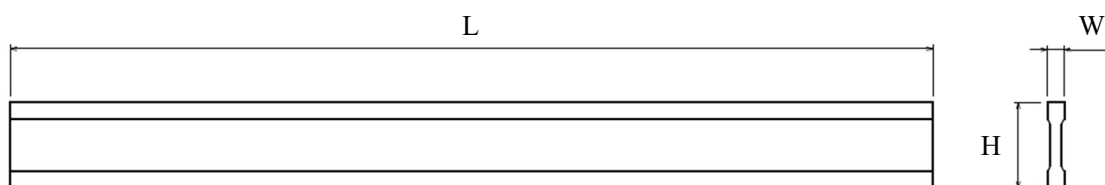

3. 仕 様

A 級

呼び寸法	寸法 (L×H×W mm)	焼入品	非焼入品	真直・平行度 (μm)	質量 (kg)
		コード No.	コード No.		
500	540×50×10	EA101	EA201	7	2.0
750	790×60×12	EA102	EA202	9.5	3.8
1000	1040×60×12	EA103	EA203	12	5.0
1500	1540×70×15	EA104	EA204	17	9.5
2000	2040×90×20	EA105	EA205	22	23.0
2500	2540×100×20	EA106	EA206	27	35.0
3000	3040×120×22	EA107	EA207	32	48.5
3500	3540×135×22	EA108	EA208	37	65.0
4000	4040×140×25	EA109	EA209	42	82.0
5000	5040×150×30	EA110	EA210	52	135.0

B 級

呼び 寸法	寸法 (L×H×W mm)	焼入品	非焼入品	真直・平行度 (μ m)	質量 (kg)
		コード No.	コード No.		
500	540×50×10	EA301	EA401	20	2.0
750	790×60×12	EA302	EA402	25	3.8
1000	1040×60×12	EA303	EA403	30	5.0
1500	1540×70×15	EA304	EA404	40	9.5
2000	2040×90×20	EA305	EA405	50	23.0
2500	2540×100×20	EA306	EA406	60	35.0
3000	3040×120×22	EA307	EA407	70	48.5
3500	3540×135×22	EA308	EA408	80	65.0
4000	4040×140×25	EA309	EA409	90	82.0
5000	5040×150×30	EA310	EA410	110	135.0

4. 使用上の注意

- ① 使用前には、使用面及びワークの測定面をきれいにしてください。
- ② 使用するときや保管時に、本器に衝撃を与えないよう注意して取り扱いってください。
- ③ 使用するところの温度になじませてご使用ください。
- ④ 温度変化の甚だしい場所等での使用や保管はしないでください。
- ⑤ 使用後は必ず防錆処理を行い、格納箱に保管してください。
- ⑥ 以下のような場合には、本器の異常の有無を確認してから使用してください。
 - ・本器を落下させたとき。
 - ・本器上に物を落下させたとき。
- ⑦ 傷等がある場合は修理・検査をおすすめします。使用面の軽微な傷等はアルカンサス砥石等で局部的に除去してからご使用ください。
- ⑧ 定期的に精度チェックをして使用してください。

- △ ⑨ 製品に鋭利な部分がある場合は、取り扱い時に指や体の他の部位を傷つけないよう注意してください。
- △ ⑩ 長さがあり、重量が重い製品についての取扱は複数名で行い、ケガには十分注意してください。
- ⑪ 必要に応じて保護手袋や保護眼鏡を着用して作業を行い、怪我を防いでください。
- △ ⑫ 損傷または劣化した本品を使用しないでください。怪我や事故の原因となる可能性があります。
- △ ⑬ 怪我が発生した場合は、直ちに応急処置を行い、必要に応じて医師に相談してください。

JIS 認証取得工場



株式会社 大菱計器製作所

OBISHI KEIKI SEISAKUSHO Co., Ltd.

本 社 〒940-1164 新潟県長岡市南陽 1 丁目 1216-1

工 場 TEL (0258) 22-1100 FAX (0258) 22-0014

東京営業所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3 丁目 5 番地

TEL (03) 3293-8881 FAX (03) 3293-8884

名古屋営業所 〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町 3 番 15 号 日重ビル 2F

TEL (052) 322-4031 FAX (052) 322-5647



■本社・工場

■精密測定機器の設計・開発、製造ならびに校正サービス

(水準器、定盤、直定規、測定基準器、直角定規、ブロック、
ダイヤルゲージスタンド、コンパレータ、角度測定器、偏心検査器、直角度測定器)

ISO9001 認証

JQA-QMA11294